PLASMATROHN

MANUEL UTILISATEUR

2022

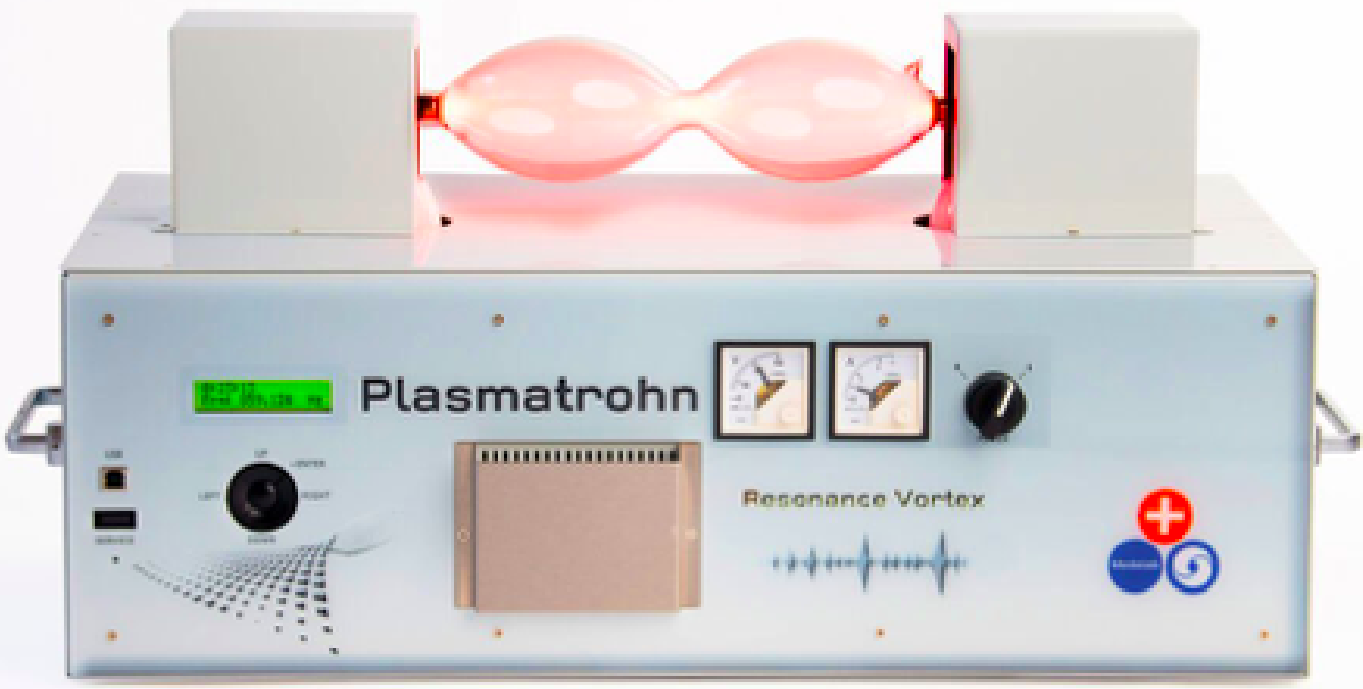

RÉVISÉ JUN. 2022
Medalab Research S.L.

www.medalab.com

Technologie

PRINCIPES FONDAMENTAUX

HISTORIQUE

La technologie PLASMATROHN® est basée sur les travaux du Dr Rife, de Tesla et du Dr Lachowsky, en référence à leurs recherches sur les fréquences qui ont débuté dans les années 1920 et 1940 et qui ont donné des résultats étonnants sur le cancer des os et d'autres maladies chroniques. Alors que le Dr Rife et d'autres utilisaient la fréquence pour éliminer les infections bactériennes et virales, l'objectif de notre logiciel est quelque peu différent.
Un corps sain est un organisme dans lequel toutes les cellules sont capables de communiquer de manière cohérente entre elles. Plasmatrohn® réalise ce processus par l'induction par résonance d'impulsions électromagnétiques de plasma à haute tension.

En fonction de la fréquence de correction, de sa force et de sa durée, les cellules entrent en auto-résonance. Cet effet d'auto-résonance est responsable de l'augmentation observée de l'activité mitochondriale, ainsi que de l'activité biophotonique et de la communication intercellulaire. Des études récentes suggèrent que l'activité mitochondriale augmente le stress cellulaire interne, ce qui peut provoquer la mitose dans les cellules saines et l'apoptose dans les cellules malades.

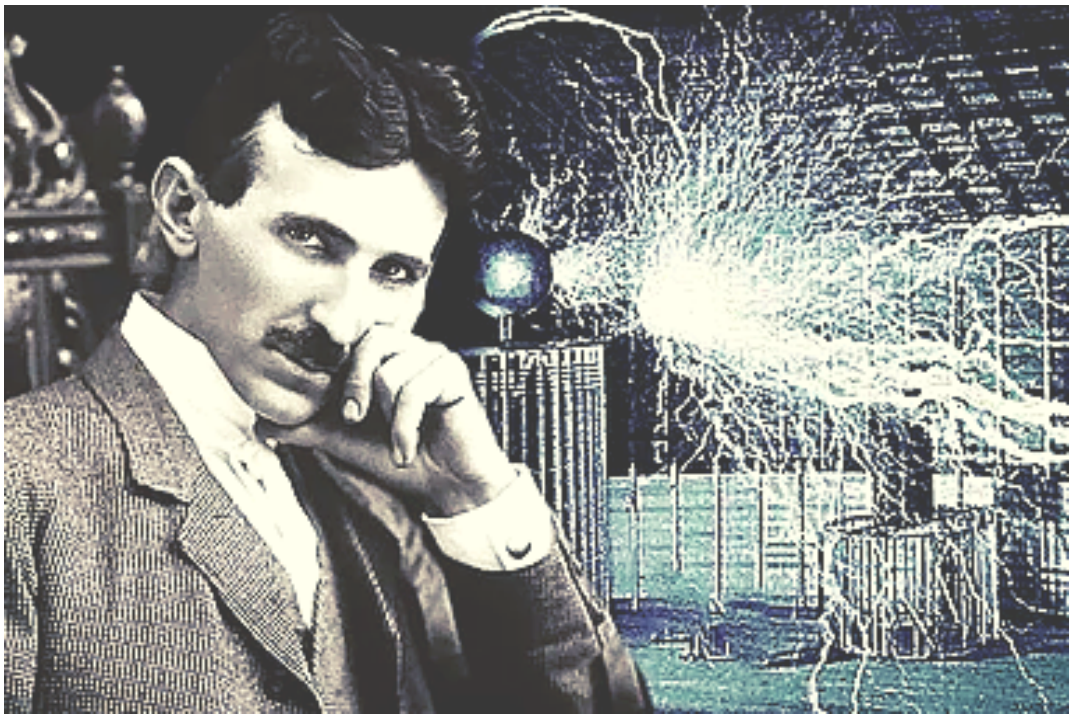

MEDALAB RESEARCH S.L. • TOUS DROITS RÉSERVÉS - 2022

Technologie

PRINCIPES FONDAMENTAUX

MODE D'ACTION ET OBJECTIF

Le Plasmatron® génère des impulsions électromagnétiques à partir d'un plasma froid à haute tension. L'un des principaux physiciens allemands ayant fait des recherches sur les ondes scalaires, le professeur Konstantin Meyl States, a pu déterminer dans ses travaux que ce type de transmission cellulaire est composé d'informations et d'énergie. Sur la base de ce principe de biophysique naturelle, le Plasmatron® est capable de créer un champ de résonance qui, en fonction des paramètres de fréquence et d'intensité utilisés, peut affecter différentes structures cellulaires du corps.
Plasmatrohn® est capable de générer un champ de référence spécifique qui influence différentes structures cellulaires en fonction des paramètres de fréquence et d'intensité. L'idée de base est que la communication cellulaire repose sur l'effet de résonance, c'est-à-dire que non seulement des informations sont envoyées d'une cellule à l'autre via des signaux biochimiques, mais aussi de l'énergie est transmise.

Plasmatrohn® peut être combiné et optimisé avec Biotrohn® . La recherche et le développement de ces logiciels complexes ont été un processus ardu qui a pris plusieurs années pour optimiser à la perfection les fréquences et les intensités. Bien qu'il existe une multitude d'appareils générateurs de fréquences sur le marché, il n'existe pas d'approche similaire à celle offerte par ces appareils : un système complexe d'oscillations de fréquences harmoniques et sous-harmoniques, de modifications diverses et de leur relation intrinsèque dans le temps.
Plasmatrohn® est capable d'utiliser des fréquences variables, ce qui permet au chercheur de générer des décharges de plasma statique avec une précision d'environ 0,001 Hz dans la gamme de fréquences allant des infrasons aux fréquences ultrasoniques de 1 à 900 000 Hz. Bien que le Plasmatron® fonctionne avec un logiciel très complexe, l'application fonctionnelle est extrêmement simple. Il n'est pas nécessaire de suivre des cours de formation spéciaux qui prennent beaucoup de temps et coûtent cher. L'appareil est entièrement "plug and play", de sorte que le traitement peut commencer immédiatement.

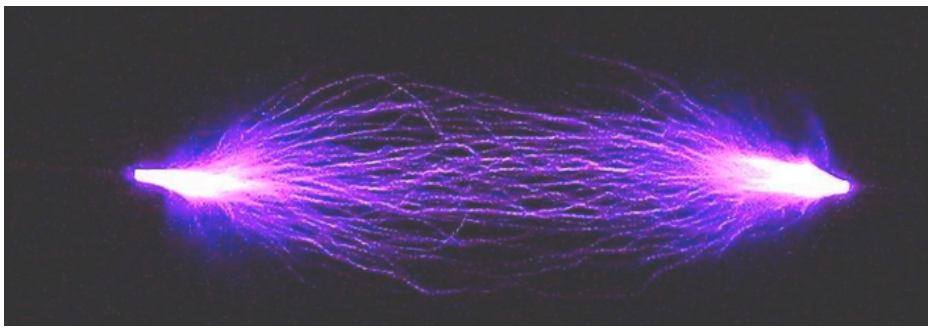

MEDALAB RESEARCH S.L. • TOUS DROITS RÉSERVÉS - 2022

Générateur de plasma

CONSIDÉRATIONS

INTRODUCTION

Le générateur de plasma PLASMATROHN n'est pas conçu pour guérir une quelconque maladie. Il ne remplace pas les soins médicaux et n'est pas un dispositif médical. Ni le fabricant ni les distributeurs ne sont responsables des utilisations du générateur Plasmatrohn autres que celles indiquées.

AVERTISSEMENTS

- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas être exposées aux effets du Plasmatrohn.
- Le générateur de plasma est conçu pour les travaux de laboratoire - vérification des effets des fréquences sur les micro-organismes vivants (parasites, bactéries, virus, champignons, prions, microzymes etc. ....) ou comme aide au traitement thérapeutique.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- USB - entrée pour la programmation du Plasmatrohn (pas pour l'utilisateur final).
- Service - à des fins de service uniquement
- POWER - interrupteur principal
- Top
- Duvet
- V - voltmètre (informatif)
- Gauche
- A - ampèremètre (informatif)
- Droit
- Enter - confirmer

MEDALAB RESEARCH S.L. • TOUS DROITS RÉSERVÉS - 2022

Fonctionnement

MISE EN ŒUVRE

DESCRIPTION

Le Plasmatrohn est équipé d'un générateur de fréquence intégré de 1 Hz à 900 kHz. A l'intérieur de cette gamme, on a établi des programmes de fréquences qui ont un effet sur un grand nombre de micro-organismes et de pathologies diverses. Le générateur de Plasmatrohn fonctionne à partir d'une fréquence de 1 Hz - où a lieu l'allumage complet des gaz à l'intérieur du tube - jusqu'à environ 5 Hz - où a lieu l'apparition de la décharge de plasma visible. La fréquence maximale que le Plasmatrohn peut transmettre sans déformer le signal de sortie est de 900 kHz. Il fonctionne donc dans une très large bande, de 1 à 900 000 Hz.
La fréquence générée par le Plasmatrohn est transmise par l'optocoupleur (qui convertit le signal électrique en lumière) à la section potentielle du générateur, qui transforme à son tour cette fréquence en une haute tension qui enflamme le mélange gazeux à l'intérieur du tube à plasma. L'inflammation des gaz dans le tube crée le plasma, qui propage ces fréquences sans contact dans un rayon de 1 à 4 m autour du générateur, distance idéale à laquelle doit se trouver la personne à traiter. Par conséquent, tous les individus présents dans cet environnement bénéficieraient des fréquences émises.

CONTRÔLE ET MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Connectez le câble 230 V à la prise 230 V située à l'arrière de l'appareil.
Les deux disjoncteurs situés à l'arrière de l'appareil doivent être en position de marche - les leviers des disjoncteurs vers le haut.
Branchez l'appareil sur une prise de courant de 230 V.
Démarrez l'appareil à l'aide du bouton principal "POWER".
(La température ambiante et la température à l'intérieur de l'appareil doivent être les mêmes - par exemple, si vous venez d'apporter l'appareil d'un endroit frais, laissez-le fonctionner pendant au moins 30 minutes "à vide", c'est-à-dire sans allumer le générateur, avec seulement le ventilateur en marche).
Mode manuel - Appuyez sur le bouton "Enter".
Choisissez une présélection avec les boutons "Haut" ou "Bas".
Lancez le programme souhaité à l'aide du bouton "Enter".

NE PAS TOUCHER LE TUBE PLASMA PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Le tube s'allume et commence immédiatement à transmettre la fréquence requise aux alentours. L'écran affiche le décompte du temps jusqu'à la fin du programme. Pendant ce temps, une résonance mutuelle (à condition que la fréquence de résonance correcte ait été sélectionnée) se produit entre l'individu récepteur et la fréquence de sortie, ce qui, selon les recherches de nombreux scientifiques, entraîne la destruction des agents pathogènes en un temps très court. Le générateur de plasma Plasmatrohn permet de vérifier ces conclusions de manière pratique. Il a été développé sur la base des découvertes du Dr Royal Raymond Rife, de Nikola Tesla, du Dr Hulda Regehr Clark et d'autres scientifiques tout aussi importants.

MEDALAB RESEARCH S.L. • TOUS DROITS RÉSERVÉS - 2022

Recommandations

- Ne lavez jamais le tube de plasma avec de l'eau ou des détergents.
- Pour le nettoyer, n'utilisez qu'un chiffon humide, et seulement si l'appareil a été débranché du réseau électrique.
- Si vous déplacez l'appareil d'un endroit frais à un endroit à température ambiante, attendez au moins 2 heures pour que la température de l'appareil et de la zone environnante s'égalise.
- Le générateur de plasma doit être en position horizontale !

Garantie

LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LA FONCTION ÉLECTRONIQUE DU GÉNÉRATEUR EST DE 24 MOIS À COMPTER DU JOUR DE LA VENTE.

Certificat de conformité : L'appareil est conforme à toutes les normes applicables aux appareils alimentés par le secteur 230V/50Hz, en particulier : EN 61326-1:06, EN 61000-3-2-06,EN 61000-3-3-95+A1:01+A2:05. Testé à l'Institut d'essais électrotechniques de Prague (entreprise publique).

MEDALAB RESEARCH S.L. · TOUS DROITS RÉSERVÉS - 2022

LISTES DES PROGRAMMES ET DES MALADIES

PLASMATROHN - LIST PAR PROGRAMME

1	Ondes alpha	0:20:00
2	Ondes bêta	0:16:40
3	Ondes gamma	0:25:00
4	Ondes delta	0:13:20
5	Ondes têtha	0:13:20
6	Ondes neurale	0:15:00
7	Fréquence universelle	1:01:40
8	Infection générale	1:02:48
9	Détoxification	0:50:28
10	Rhume	0:56:01
11	Grippe virale	0:58:33
12	Sinusite	0:30:00
13	Asthme pulmonaire	1:03:35
14	Bronchite	0:53:20
15	Voies respiratoires pulmonaires	0:53:20
16	Pneumonie	0:30:00
17	Allergie générale	0:59:20
18	Côlon irritable	1:00:00
19	Néphrite	0:33:20
20	Anxiété	0:30:00
21	Fatigue générale	0:57:30
22	L'harmonie interne	0:30:00
23	Insomnie	0:58:30
24	Acidose	1:00:11
25	Inflammations	0:56:42
26	Hypertension	0:52:20
27	Infection urinaire	0:57:56
28	Herpès simplex	0:51:48
29	Herpès génitale	1:01:01
30	Herpès zoster	0:59:20
31	Virus epstein barr	1:00:55
32	Cytomégalovirus	0:56:46
33	Rarilomavirus	0:59:32
34	Adénovirus	1:00:26
35	Coronavirus	0:48:00
36	Virus VIH	1:00:34
37	Virus Coxsackie	1:06:20
38	Pneumonie mycoplasme	1:05:20
39	Staphylocoque aurius	0:58:04
40	Ptocoque bêta	1:06:40
41	Streptocoque pneumoniae	1:01:44
42	Pseudonomas Aeuruginosa	1:11:01
43	Streptocoque pyogènes	0:57:34
44	Escherichia Coli	0:57:49
45	Borrelia Burgdoferi	1:00:20
46	Chlamydia Pneumoniae	1:15:03
47	Chlamydia Trachomatis	1:03:51
48	Nonlicobacter pylori	1:10:41
49	Toxoplasma Gondi	0:55:20
50	Oxyurose	1:08:06
51	Giardia lamblia	0:59:20
52	Trichomonas vaginalis	1:04:20
53	Mal de tête	0:57:20
54	Mal de dents	0:57:21
55	Mal de cou	1:00:03
56	Mal de dos	1:00:51
57	Mal de genou	1:00:10
58	Aspergillose	0:58:52
59	Candidose	1:00:00
60	Mycose teigne	0:56:44
61	Aflatoxine	1:33:33
62	Globules blancs	1:00:50
63	Circulation sanguine	0:50:00
64	Système lymphatique	1:25:00
65	Stimulation immunitaire	0:57:00
66	Stabilisation immunitaire	0:50:01
67	Anti convulsion	1:00:00
68	Arthrite	0:59:32

69	Rhumatisme	1:07:45
70	Lupus érythémateux	1:01:00
71	Fatigue chronique	1:05:40
72	Fibromyalgie	1:31:10
73	Psoriasis	0:53:20
74	Sclérose multiple	1:20:24
75	Maladie de Charcot	1:03:42
76	Hyperthyroïdie	1:00:00
77	Hypothyroïdie	1:28:56
78	Pancréatite	0:52:47
79	Hépatite	1:27:16
80	Ulcères	0:53:30
81	Polypes Utérines	0:57:42
82	Tumeurs malignes	0:53:21
83	Oncovirus	1:00:00
84	Hémorroïdes	0:54:20
85	Stimulation du foie	1:59:52
86	Stimulation rénale	0:53:06
87	Glande surrénale	0:56:40
88	Vésicule biliaire	0:53:20
89	Prostatite	0:56:57
90	Addictions	1:00:00
91	Infertilité	1:00:56
92	Colite ulcéreuse	0:50:40
93	Cystite chronique	0:50:08
94	Dégénérescence maculaire	0:53:20
95	Glaucome	1:06:12
96	Asperger	0:30:00
97	Autisme- T.E.A	1:03:36
98	Maladie cœliaque	1:02:49
99	Méningite	0:33:20
100	Encéphalite	0:33:20
101	Toxoplasmose	0:58:20
102	Diabète de type 1	0:52:33
103	Diabète de type 2	0:30:34
104	Diabète ulcératif	0:55:56
105	Cataracte	0:30:00
106	La maladie de Crohn	0:56:00
107	Cancer : généralités	0:55:49
108	Cancer : carcinome	0:51:47
109	Cancer : sarcome	0:58:20
110	Cancer : fibrosarcome	0:33:00
111	Cancer : neurobastome	0:30:00
112	Cancer : glioblastome du cerveau	0:37:30
113	Melanoma	0:54:40
114	Adenoma	0:54:10
115	Cancer : myélome	0:54:20
116	Cancer : lymphome	0:58:41
117	Cancer : rhabdomyosarcome	0:50:05
118	Cancer : plasmocytome	0:51:20
119	Cancer : sein	0:56:00
120	Cancer : hodgkin	0:58:20
121	Cancer : non hodgkin	0:56:00
122	Cancer : leucémie	0:54:54
123	Cancer : métastases	0:55:54
124	Cancer : prostate	0:53:47
125	Cancer : peau	0:54:40
126	Cancer : vessie	0:58:32
127	Cancer : cervical	0:59:16
128	Cancer : foie	0:58:32
129	Cancer : pancréas	0:54:00
130	Cancer : estomac	0:56:29
131	Cancer : os	0:51:00
132	Cancer : oeil	0:51:00
133	Cancer : oral	0:52:45
134	Cancer : utérin	0:54:32
135	Cancer : ovaire	0:54:40

PLASMATROHN - PROGRAMMES CLASSÉS PAR PATHOLOGIES

24	Acidose	01:00:11
90	Addictions	01:00:00
114	Adenoma	00:54:10
34	Adénovirus	01:00:26
61	Aflatoxine	01:33:33
17	Allergie générale	00:59:20
67	Anti convulsion	01:00:00
20	Anxiété	00:30:00
68	Arthrite	00:59:32
96	Asperger	00:30:00
58	Aspergillose	00:58:52
13	Asthme pulmonaire	01:03:35
97	Autisme- T.E.A	01:03:36
45	Borrelia Burgdoferi	01:00:20
14	Bronchite	00:53:20
108	Cancer : carcinome	00:51:47
127	Cancer : cervical	00:59:16
130	Cancer : estomac	00:56:29
110	Cancer : fibrosarcome	00:33:00
128	Cancer : foie	00:58:32
107	Cancer : généralités	00:55:49
112	Cancer : glioblastome du cerveau	00:37:30
120	Cancer : hodgkin	00:58:20
122	Cancer : leucémie	00:54:54
116	Cancer : lymphome	00:58:41
123	Cancer : métastases	00:55:54
115	Cancer : myélome	00:54:20
111	Cancer : neurobastome	00:30:00
121	Cancer : non hodgkin	00:56:00
132	Cancer : oeil	00:51:00
133	Cancer : oral	00:52:45
131	Cancer : os	00:51:00
135	Cancer : ovaire	00:54:40
129	Cancer : pancréas	00:54:00
125	Cancer : peau	00:54:40
118	Cancer : plasmocytome	00:51:20
124	Cancer : prostate	00:53:47
117	Cancer : rhabdomyosarcome	00:50:05
109	Cancer : sarcome	00:58:20
119	Cancer : sein	00:56:00
134	Cancer : utérin	00:54:32
126	Cancer : vessie	00:58:32
59	Candidose	01:00:00
105	Cataracte	00:30:00
47	Chlamydia Trachomatis	01:03:51
63	Circulation sanguine	00:50:00
92	Colite ulcéreuse	00:50:40
18	Côlon irritable	01:00:00
35	Coronavirus	00:48:00
93	Cystite chronique	00:50:08
32	Cytomégalovirus	00:56:46
94	Dégénérescence maculaire	00:53:20
9	Détoxification	00:50:28
102	Diabète de type 1	00:52:33
103	Diabète de type 2	00:30:34
104	Diabète ulcératif	00:55:56
100	Encéphalite	00:33:20
44	Escherichia Coli	00:57:49
71	Fatigue chronique	01:05:40
21	Fatigue générale	00:57:30
72	Fibromyalgie	01:31:10
7	Fréquence universelle	01:01:40
51	Giardia lamblia	00:59:20
87	Glande surrénale	00:56:40
95	Glaucome	01:06:12
62	Globules blancs	01:00:50
11	Grippe virale	00:58:33
84	Hémorroïdes	00:54:20

79	Hépatite	01:27:16
29	Herpès génitale	01:01:01
28	Herpès simplex	00:51:48
30	Herpès zoster	00:59:20
26	Hypertension	00:52:20
76	Hyperthyroïdie	01:00:00
77	Hypothyroïdie	01:28:56
8	Infection générale	01:02:48
27	Infection urinaire	00:57:56
91	Infertilité	01:00:56
25	Inflammations	00:56:42
23	Insomnie	00:58:30
22	L'harmonie interne	00:30:00
106	La maladie de Crohn	00:56:00
70	Lupus érythémateux	01:01:00
55	Mal de cou	01:00:03
54	Mal de dents	00:57:21
56	Mal de dos	01:00:51
57	Mal de genou	01:00:10
53	Mal de tête	00:57:20
98	Maladie cœliaque	01:02:49
75	Maladie de Charcot	01:03:42
113	Melanoma	00:54:40
99	Méningite	00:33:20
60	Mycose teigne	00:56:44
19	Néphrite	00:33:20
48	Nonlicobacter pylori	01:10:41
1	Ondes alpha	00:20:00
83	Oncovirus	01:00:00
2	Ondes bêta	00:16:40
4	Ondes delta	00:13:20
3	Ondes gamma	00:25:00
6	Ondes neurale	00:15:00
5	Ondes têtha	00:13:20
50	Oxyurose	01:08:06
78	Pancréatite	00:52:47
16	Pneumonie	00:30:00
38	Pneumonie mycoplasme	01:05:20
46	Chlamydia Pneumoniae	01:15:03
81	Polypes Utérines	00:57:42
89	Prostatite	00:56:57
42	Pseudonomas Aeuruginosa	01:11:01
73	Psoriasis	00:53:20
40	Ptocoque bêta	01:06:40
33	Rarilomavirus	00:59:32
69	Rhumatisme	01:07:45
10	Rhume	00:56:01
74	Sclérose multiple	01:20:24
12	Sinusite	00:30:00
66	Stabilisation immunitaire	00:50:01
39	Staphylocoque aurius	00:58:04
85	Stimulation du foie	01:59:52
65	Stimulation immunitaire	00:57:00
86	Stimulation rénale	00:53:06
41	Streptocoque pneumoniae	01:01:44
43	Streptocoque pyogènes	00:57:34
64	Système lymphatique	01:25:00
49	Toxoplasma Gondi	00:55:20
101	Toxoplasmose	00:58:20
52	Trichomonas vaginalis	01:04:20
82	Tumeurs malignes	00:53:21
80	Ulcères	00:53:30
88	Vésicule biliaire	00:53:20
37	Virus Coxsackie	01:06:20
31	Virus epstein barr	01:00:55
36	Virus VIH	01:00:34
15	Voies respiratoires pulmonaires	00:53:20

MEDALAB